

Số: 199 /TTYT-KD
V/v Mời tham gia báo giá thiết bị
y tế

Yên lạc, ngày 15 tháng 03 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm y tế huyện Yên Lạc có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu **Mua máy bơm tiêm điện tự động phục vụ công tác chuyên môn cho Trung tâm y tế huyện Yên Lạc** với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm y tế huyện Yên Lạc
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ tên: Nguyễn Thị Thu Mai

Chức vụ: Trưởng khoa Dược- TTB- VTYT

SĐT: 0979 144 322

Email: khoaduoccttyyenlac@gmail.com

- Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược- TTB- VTYT, Trung tâm y tế huyện Yên Lạc

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 15 tháng 03 năm 2024 đến trước 08h30 ngày 25 tháng 03 năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 25 tháng 03 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục thiết bị y tế:

STT	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Máy bơm tiêm điện tự động	Mô tả cụ thể tại Phụ lục kèm theo	Chiếc	01
Tổng cộng: 01 mặt hàng				



2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản vật tư, dụng cụ y tế:

- Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Mô tả cụ thể tại Phụ lục đính kèm theo

- Các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Nhà cung cấp chịu trách nhiệm toàn bộ việc vận chuyển, lắp đặt, bảo hành, chi phí đào tạo hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản, bảo trì cho cán bộ kỹ thuật, giao hàng tại nơi sử dụng.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: trong 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

Thanh toán cho nhà cung cấp 100% giá trị của hợp đồng sau khi bên B bàn giao đầy đủ hàng hóa và hóa đơn tài chính.

5. Các thông tin khác (nếu có).

Đính kèm theo Phụ lục mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các thiết bị y tế; các yêu cầu về địa điểm cung cấp, lắp đặt.

Trung tâm y tế huyện Yên Lạc kính đề nghị các đơn vị quan tâm gửi Báo giá theo đúng các nội dung nêu trên.


Xin trân trọng cảm ơn! *rs*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Webservice TTYT Yên Lạc;
- Lưu: KD, HSĐT.



Nguyễn Hoàng Phương

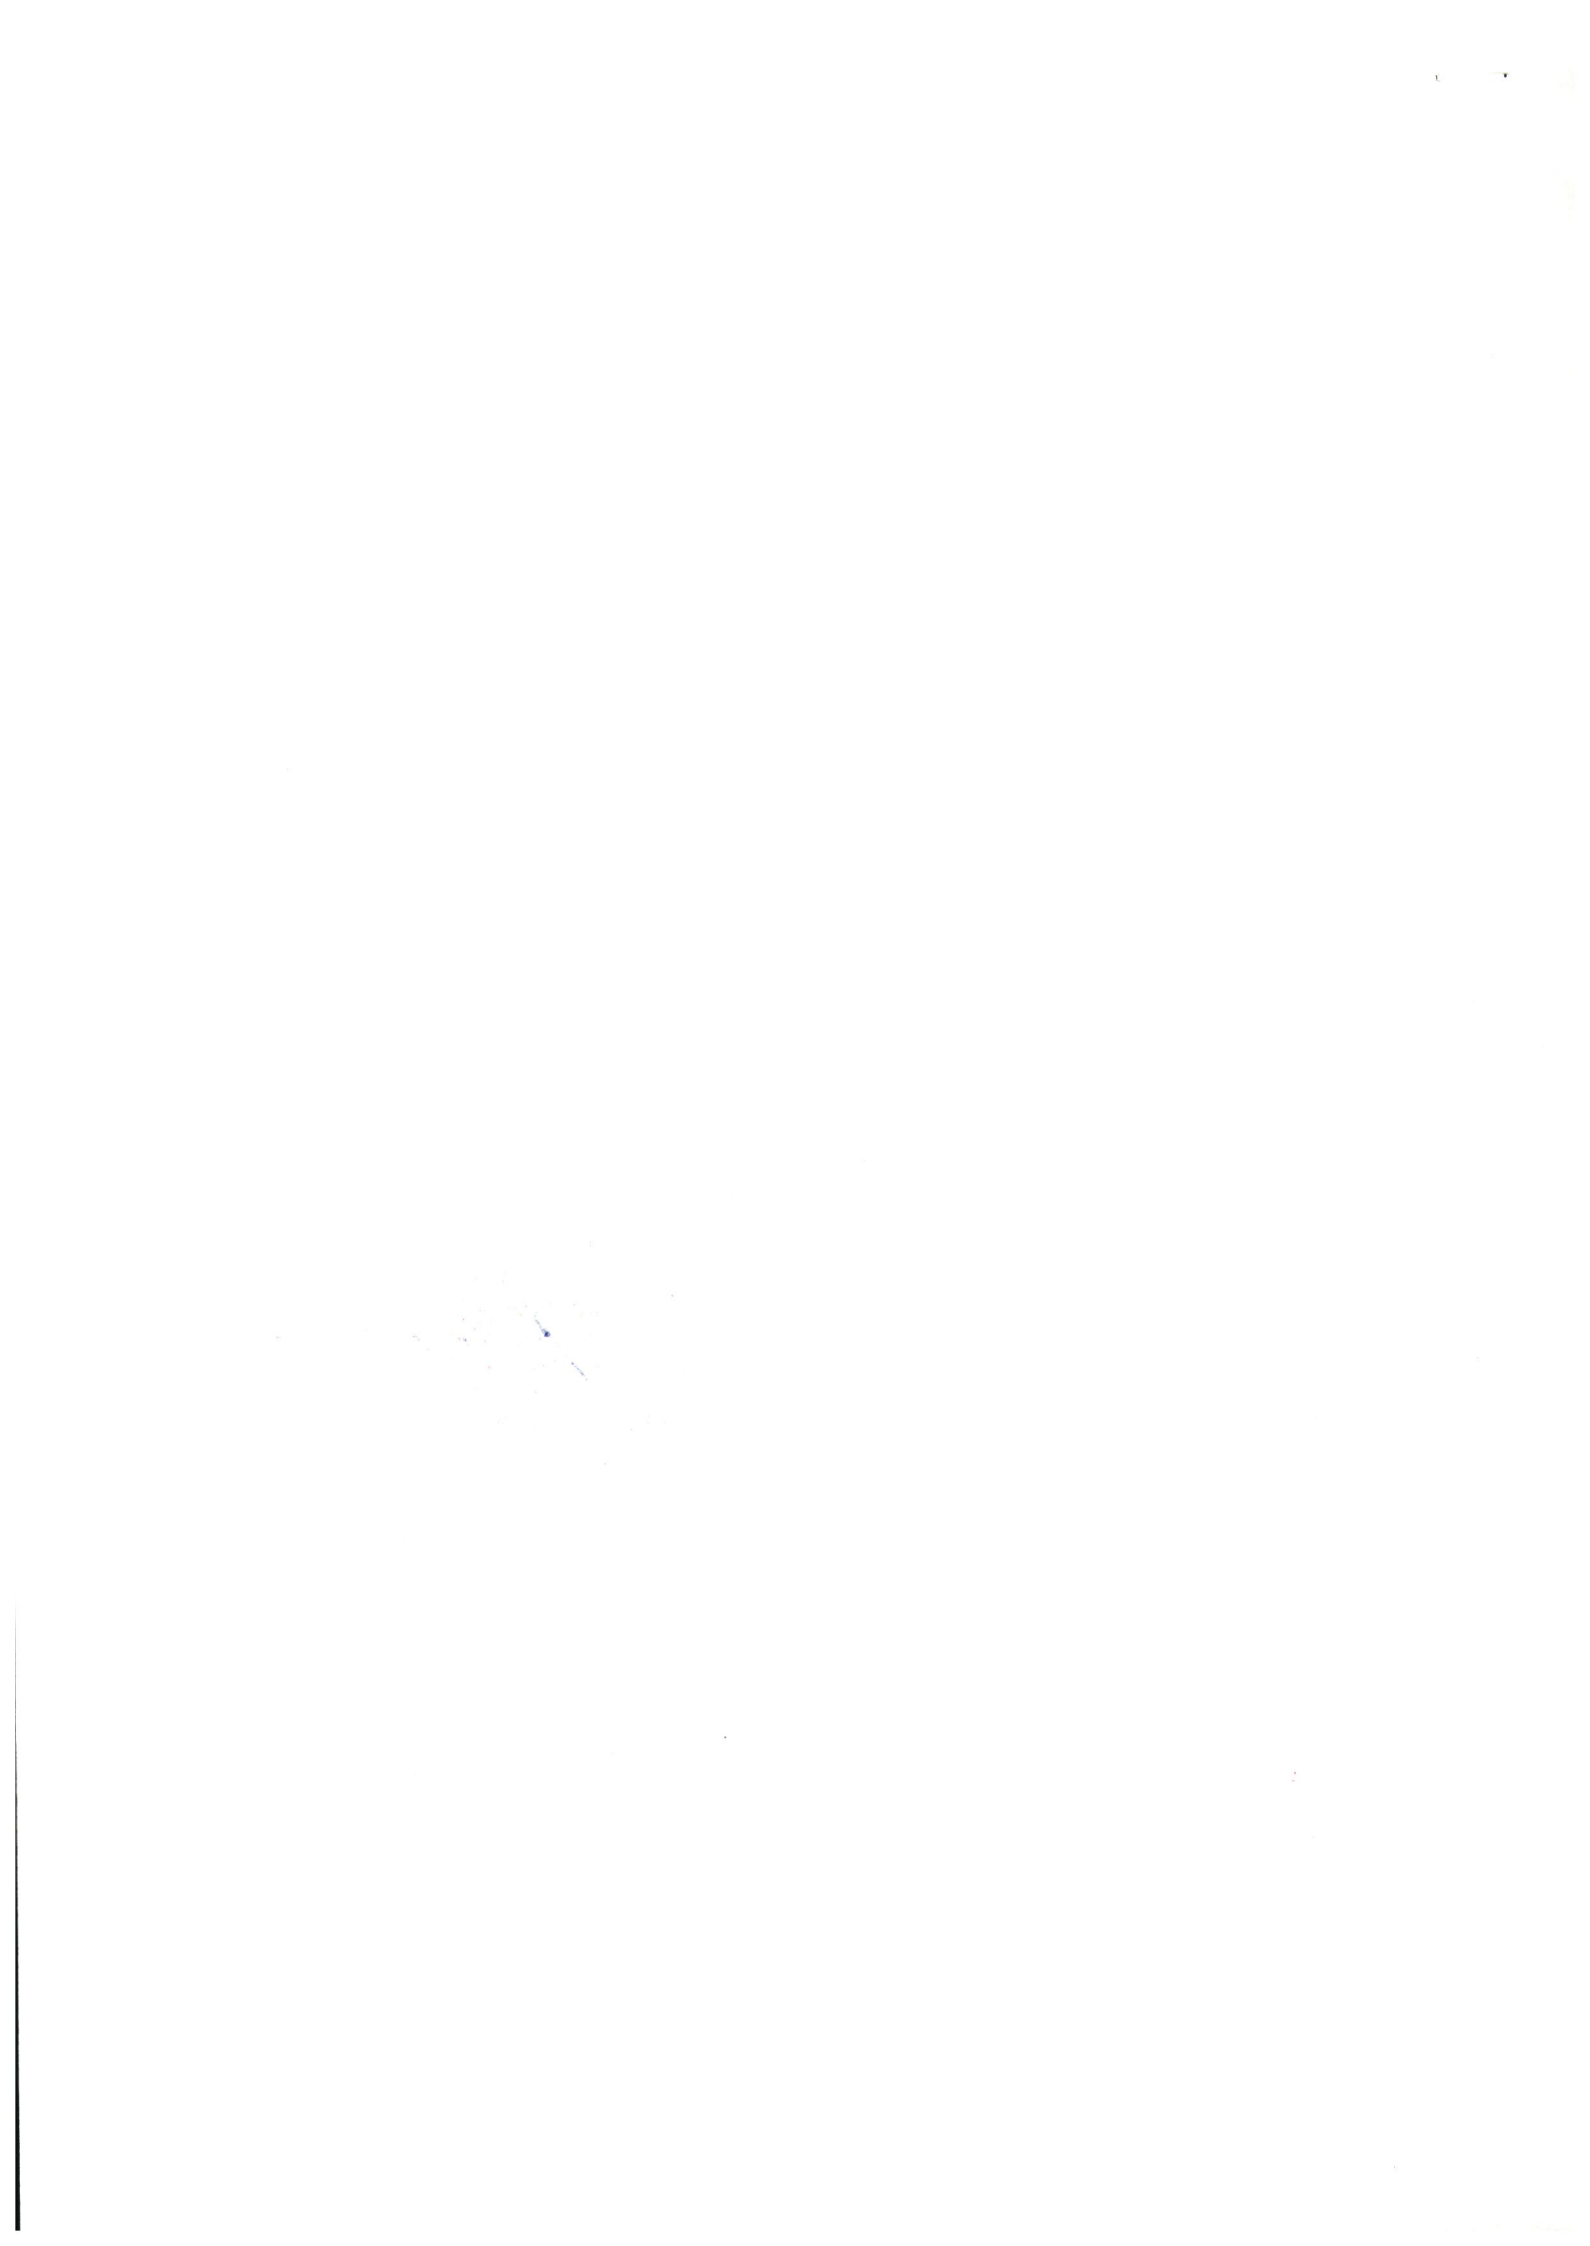

PHỤ LỤC

Bảng mô tả các lĩnh năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các thiết bị y tế; các yêu cầu về địa điểm cung cấp, lắp đặt
 (Kèm theo Văn bản số 199/TTYT-KD ngày 15/03/2024 của Trung tâm y tế huyện Yên Lạc)

STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Địa điểm cung cấp, lắp đặt
1	Máy bơm tiêm điện tự động	Thiết bị mới 100%, sản xuất 2023 trở về sau, thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng kể từ ngày bàn giao thiết bị. Cung cấp bao gồm : - Máy chính - Dây nguồn - Công tắc điều khiển PCA - Sách hướng dẫn sử dụng (Anh Việt) Thông số kỹ thuật Kích thước ống tiêm: 10, 20, 30, 50 ml Ống tiêm: TOP, Terumo, Nipro, JMS, B-D, Monoject, B.Braun, AstraZeneca (1% Diprovan® Injection Kit 20ml and 50ml. Đơn vị bơm truyền: Trong mode TIVA: ml/h, pg/kg/min, mg/kg/h. Trong mode PCA: ml/h, pg/h, mg/ h Tốc độ truyền: Trong mode TIVA: 0.1-200.0ml/h (ống tiêm 10ml) *0.1-400.0ml/h(ống tiêm 20ml) *0.1-500.0ml/h(ống tiêm 30ml) *0.1-800.0ml/h(ống tiêm	Chiếc	01	Khoa Ngoại-GMHS TTYT huyện Yên Lạc



	hình. Cài đặt tốc độ tối đa.		
Môi trường hoạt động	Nhiệt độ: 5 – 400C, độ ẩm 20 – 90%, áp suất: 70 – 160kPa.		
Vận chuyển/ lưu trữ	Nhiệt độ: -20 – 450C, độ ẩm 10 – 950%, áp suất: 50 – 106kPa.		
Nguồn cung cấp	Nguồn AC	AC 100 – 127V ±10%, 50/60Hz	
		AC 200 – 240V ±10%, 50/60Hz	
		DC từ 9 – 15V, 5W	
		Nguồn DC bên ngoài	
	Nguồn DC bên trong	3.6V, 1500mAh NiMH(truyền được tối đa 12 giờ sử dụng) (Type: BP-55)	
	Pin xác AA	DC 6V, thời gian sử dụng 24h (type: LR-6)	
Chuẩn an toàn	Class II, type CF, IPX1		
Cầu chì	TL 0.2A		
Kích thước / Trọng lượng	320(W) x 90(H) x 160(D) / Khoảng 2kg		
Tổng: 01 mặt hàng			